



ROYAL MEDICAL DEL BAJÍO S.A. DE C.V.

Distribuidor de Material y Equipo Médico

Reg. Fea. de Cnus. RMB-960201-JZ9

MATRIZ
20 DE ENERO 604
CENTRO
LEÓN. GTO.
TELS.: (01 477) 716-09-64
716-96-66/FAX: 714-58-41

S U C U R S A L E S
PASEO DE LOS VIRREYES 204
COL. VIRREYES
C.P: 76175 QUERETARO, QRO
TEL.: (01 442)242-37-11

JULIÁN DE LOS REYES 560
CENTRO
SAN LUIS POTOSI, SLP
TEL.-FAX: (01 444)814-53-51
812-19-62

www.rmmedical.com.mx E-mail: rbleon@prodiQy.not.mx

LEON, GTO. A 17 DE ENERO DEL 2019
CLUB ROTARIO DE SAN FELIPE GTO.
ATN. SR. JOSE MARCOS GONZALEZ GOMEZ

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE ENVIO LA COTIZACION DEL EQUIPO
DE ULTRASONIDO.

SONOACE -R7 MCA.



Diseño

- Delgado y compacto diseño
- Monitor de 19 pulgadas LED
- Mecanismo de Panel de control arriba / abajo
- Teclado retro iluminado
- Panel de control simple
- Manijas delanteras y traseras
- 4 ruedas giratorias

ULTRASONIDOS Y
ACCESORIOS

ENDOSCOPIA

VIDEO
ENDOSCOPIA

LAPAROSCOPIA

ELECTRO-
CARDIOGRAFOS

MONITORES DE
PACIENTE

DOPPLERS

EQUIPOS DE
ANESTECIA

LAMPARAS DE
QUIROFANO

MESAS DE
CIRUGIA



CUCHILLO
ELECTRICOS

MONITOR FETAL

DESFRIBILADOR

MUEBLES DE
HOSPITAL Y
CONSULTORIO

INSTRUMENTAL
QUIRURGICO

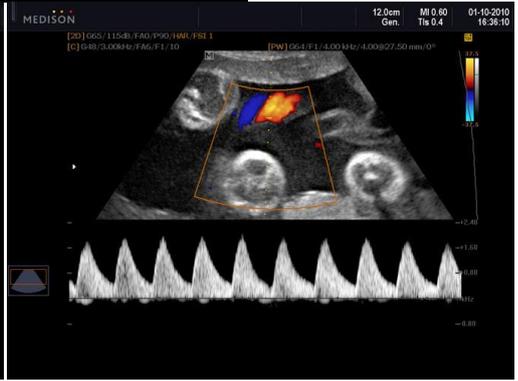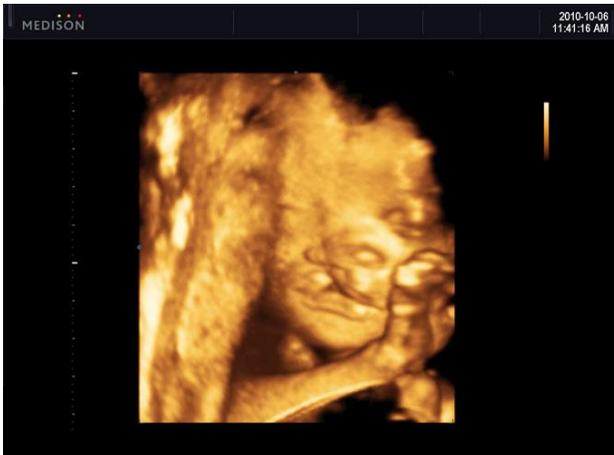



ROYAL MEDICAL DEL BAJÍO S.A. DE C.V.

Distribuidor de Material y Equipo Médico

Reg. Fea. de Cnus. RMB-960201-JZ9

MATRIZ
20 DE ENERO 604
CENTRO
LEÓN. GTO.
TELS.: (01 477) 716-09-64
716-96-66/FAX: 714-58-41

S U C U R S A L E S
PASEO DE LOS VIRREYES 204
COL. VIRREYES
C.P: 76175 QUERETARO, QRO
TEL.: (01 442)242-37-11

JULIÁN DE LOS REYES 560
CENTRO
SAN LUIS POTOSI, SLP
TEL.-FAX: (01 444)814-53-51
812-19-62

www.rmmedical.com.mx E-mail: rmbleon@prodiQy.not.mx

TRASONIDOS Y
CESORIOS

DOSCOPIA

DEO

DOSCOPIA

PAROSCOPIA

ELECTRO-
RDIOGRAFOS

ONITORES DE
CIENTE

OPPLERS

UIPOS DE
ESTECIA

MPARAS DE
UIROFANO

ESAS DE
RUGIA

CHILLO
ECTRICOS

ONITOR FETAL

SFRIBILADOR

UEBLES DE
OSPITAL Y

NSULTORIO

STRUMENTAL
JIRURGICO

Funcionalidad

- 4D Live
- 3DXI paquete de diagnóstico
- Imagen
- Dynamic MR / Dynamic MR + (DMR)
- Filtro de Reducción de manchas
- Quick Scan
- Post-proceso
- Medición del anuncio
- Personalización de usuario completa conectividad
- Sonoview Pro- Análisis fuera de línea

Multi-Beam Processing

Multi-Beam Imaging es una técnica que consiste en la creación de varias líneas de escaneado de imágenes en un TX. La técnica de haz múltiple es posible a través de la formación de haz digital de, y es una función que no se puede hacer con los actuales analógicas formación de haz métodos.

Apertura Sintética

Control de apertura sintética es un método para superar los límites del canal físico mediante el uso de software. Para crear una línea de exploración, el TX y RX se llevan a cabo dos veces.

Harmonic Imaging

La teoría básica de la imagen armónica es que el tejido corporal refleja señales a frecuencias de ultrasonido a dos veces la frecuencia de exploración, o el segundo armónico de la frecuencia de exploración. Harmonic Imaging Samsung Medison es una versión avanzada de la imagen armónica convencional.

CONECTIVIDAD

- DICOM 3.0
- Impresoras USB
- Grabación de DVD y Escritura
- Copia de seguridad, exportación, transferencia
- Memoria Flash USB
- Módulo EC

ROYAL MEDICAL DEL BAJIO S.A. DE C.V.

Distribuidor de Material y Equipo Médico

Reg. Fea. de Cnus. RMB-960201-JZ9

MATRIZ
20 DE ENERO 604
CENTRO
LEÓN. GTO.
TELS.: (01 477) 716-09-64
716-96-66/FAX: 714-58-41

S U C U R S A L E S
PASEO DE LOS VIRREYES 204
COL. VIRREYES
C.P: 76175 QUERETARO, QRO
TEL.: (01 442)242-37-11

JULIÁN DE LOS REYES 560
CENTRO
SAN LUIS POTOSI, SLP
TEL.-FAX: (01 444)814-53-51
812-19-62

www.rmmedical.com.mx E-mail: rubleon@prodiQy.not.mx

TRASONIDOS Y
CESORIOS

DOSCOPIA

DEO

DOSCOPIA

PAROSCOPIA

ELECTRO-
RDIOGRAFOS

DNITORES DE
CIENTE

OPPLERS

UIPOS DE
ESTECIA

MPARAS DE
UIROFANO

ESAS DE
RUGIA

CHILLO
ECTRICOS

DNITOR FETAL

SFRIBILADOR

UEBLES DE
OSPITAL Y

NSULTORIO


STRUMENTAL
IRURGICO

Filtro de reducción de speckle TM

La función SRF reduce speckle artefactos y artefactos de baja señal en el fondo y en los órganos. La imagen resultante tiene una imagen más clara que la imagen original.


Proyección de imagen Full Spectrum

Espectro de formación de imágenes está diseñado para formación de imágenes utilizando el territorio de frecuencias que soporta la sonda, no importa cómo la frecuencia de transmisión es designado. El rango de frecuencia puede ser ampliado para una mejor penetración y resolución.

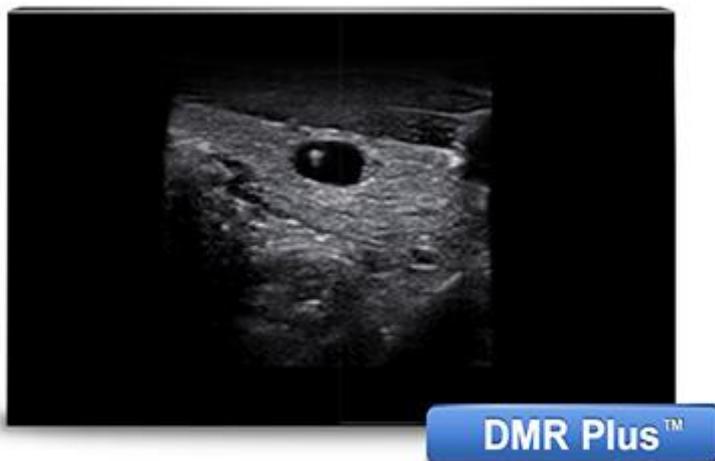

DynamicMR TM

DynamicMR TM reduce significativamente los artefactos tales como manchas engañosas y el ruido de una imagen de ultrasonido 2D, a través de un innovador de la segunda etapa de filtrado, Filtrado de objetos y filtrado de píxeles.

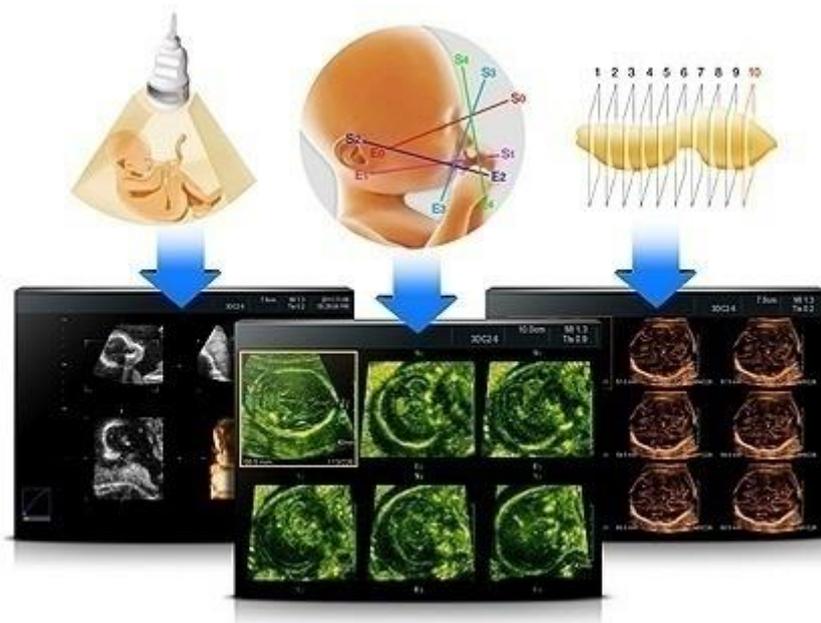

3D TM XI - Multi-Slice View TM

Múltiples Slice TM Ver transforma los datos 3D obtenidos a partir de un volumen de exploración regular de ultrasonido en una serie de imágenes secuenciales capturadas en intervalos de 0,5 mm (mínimo) a segmentos de 5 mm (máximo).

3D XI TM - TM Oblique View

TM Ver oblicua es una tecnología de imagen que le permite examinar y ver los datos de volumen 3D en diferentes planos de vista sin limitaciones.



ROYAL MEDICAL DEL BAJÍO S.A. DE C.V.

Distribuidor de Material y Equipo Médico

Reg. Fea. de Cnus. RMB-960201-JZ9

MATRIZ
20 DE ENERO 604
CENTRO
LEÓN. GTO.
TELS.: (01 477) 716-09-64
716-96-66/FAX: 714-58-41

S U C U R S A L E S
PASEO DE LOS VIRREYES 204
COL. VIRREYES
C.P: 76175 QUERETARO, QRO
TEL.: (01 442)242-37-11

JULIÁN DE LOS REYES 560
CENTRO
SAN LUIS POTOSI, SLP
TEL.-FAX: (01 444)814-53-51
812-19-62

www.rmmedical.com.mx E-mail: rmbleon@prodiQy.not.mx

INCLUYE:

- UNIDAD PRINCIPAL , MONITOR DE LED PLANO DE 19”

- 4 TRANSDUCTORES.
- COMVEXO 2-8 MHZ
- LINEAL DE 5-12 MHZ.
- VAGINAL DE 4-9 MHZ
- VOLUMETRICO ABDOMINAL DE 2-8 MHZ.
- DMR
- 3D, 4D.
- QUEMADOR DE CD.
- UPS. REGULADOR DE VOLTAJE
- IMPRESORA SONY 898
- 12 ROLLOS DE PAPEL PARA LA IMPRESORA GLOS Y
- CAPACITACION INCLUIDA
- 1 AÑOS DE GARANTIA

PRECIO: **544,000.00 PESOS NETO CONTADO**

- GARANTIA UN AÑO
- TIEMPO DE ENTREGA 20 DIAS
- SERVICIO PREVENTIVO: DESPUES DE 2 AÑOS \$ 8,000 M.N NETO.
- **SERVICIO CORRECTIVO: DESPUES DE GARANTIA DEPENDEN DE DE LA FALLA SE COTIZA EL COSTO.**

ATENTAMENTE

“ROYAL MEDICAL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

ROGELIO AGUILAR SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL
CEL. 4777249539

TRASONIDOS Y
CESARIOS

DOSCOPIA

DEO

DOSCOPIA

PAROSCOPIA

ELECTRO-
RDIOGRAFOS

MONITORES DE
CIENTE

OPPLERS

QUIPOS DE
ESTECIA

MPARAS DE
UIROFANO

ESAS DE
RUGIA

CHILLO
ELECTRICOS

MONITOR FETAL

SFRIBILADOR

JEABLES DE
OSPITAL Y
NSULTORIO

STRUMENTAL
JIRURGICO